

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の検査項目におきまして、測定機器および試薬変更のため、検査受託内容の一部を変更させて頂きたくご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、弊社事情をご賢察のうえご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

変更項目および変更内容

▼2024年8月13(火)受託分より変更

項目コード	検査項目 (グループコード)	変更内容	新	現	変更理由	総合検査 案内 掲載頁	備考
8666	クラミジアトラコマチス IgG・IgA 抗体 (7151)	報告範囲	0.01 ～ 40.00以上	0.01 ～ 99999.99	測定機器変更 のため	53	*ア

委託先:保健科学 第2ラボラトリー(略号:*ア)

※基準値・総合判定方法含めその他変更はございません。

▼2024年8月14(水)受託分より変更

項目コード	検査項目 (グループコード)	変更内容	新	現	変更理由	総合検査 案内 掲載頁	備考
4859	タクロリムス (5256)	報告範囲	0.50 ～ 40.00	2.0 未満 ～ 30.0 以上	試薬変更 のため	108	*A
3544	シクロスポリン (5465)	報告範囲	30.0 ～ 2000.0	30.0 未満 ～ 1500.0 以上			

委託先:保健科学総合研究所(略号:*A)

※基準値含めその他変更はございません。

※詳細につきましては、裏面の内容をご参照ください。




保健科学グループ


保健科学研究所 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106 TEL. 045-333-1661
保健科学東日本 〒365-8585 埼玉県鴻巣市天神3-673 TEL. 048-543-4000
保健科学西日本 〒612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町328 TEL. 075-933-6060

▼現行試薬と新試薬の比較

〔クラミジアトラコマチスIgG抗体〕

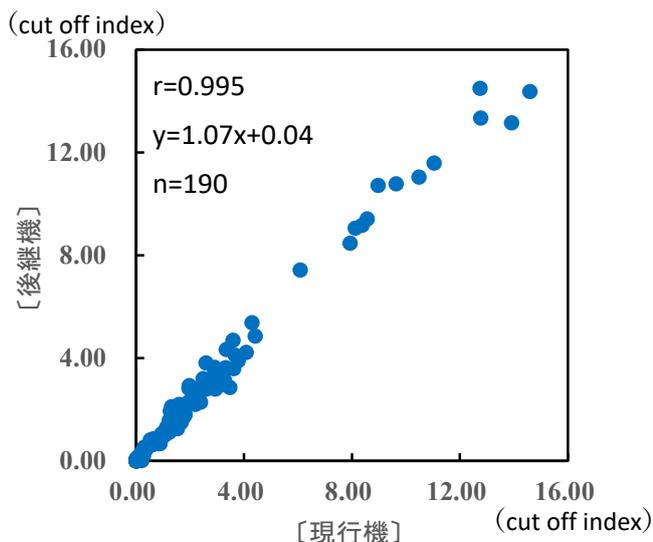

〔クラミジアトラコマチスIgA抗体〕

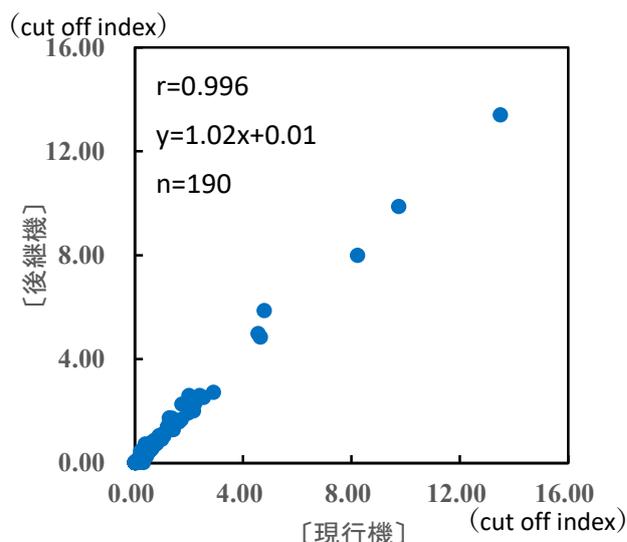


8666(7151) クラミジアトラコマチスIgG抗体		現行機			
		-	+	±	合計
後継機	-	116	0	0	116
	+	0	65	0	65
	±	0	0	9	9
	合計	116	65	9	190

全体一致率(%) : 100

8666(7151) クラミジアトラコマチスIgA抗体		現行機			
		-	+	±	合計
後継機	-	157	0	0	157
	+	0	26	0	26
	±	0	0	7	7
	合計	157	26	7	190

全体一致率(%) : 100

〔タクロリムス〕

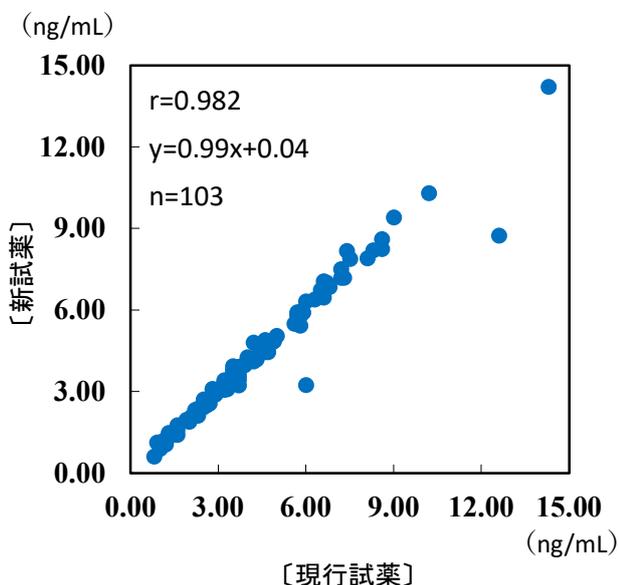

〔シクロスポリン〕

